
Clameau pour accessoires 10-302, versions incluses

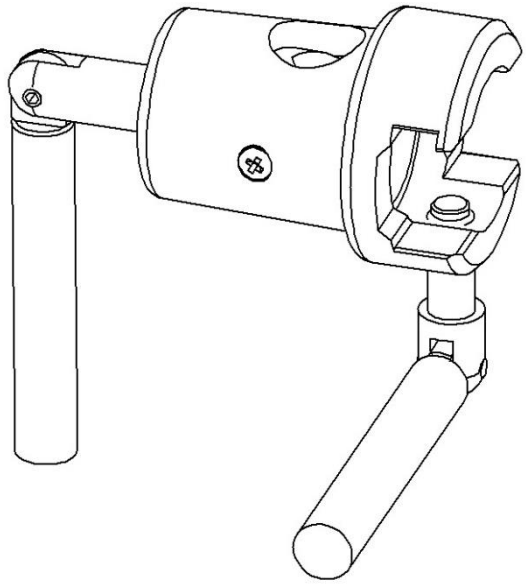

Version	Description	Type de tige	
10-302	**Clameau (rail UE 25 x 10 mm) avec goujon en V**		**Ø 16 - 20 mm**
10-302-P	**Clameau (rail UE 25 x 10 mm) avec goujon plat**		**Ø 16 - 20 mm**

Mise en garde ! Ce symbole indique des informations importantes relatives à la sécurité. Suivez attentivement ces instructions.

Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation ! Il est important de bien comprendre le contenu du manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement.

CE

02-09-2021
Numéro de document : M10-302FR rév. 01

Utilisation prévue

Clameau destiné à fixer et positionner des accessoires, avec une taille de tige de Ø 16-20 mm, sur le rail pour accessoires sur les tables d'opération et d'examen. Le produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale.


Consignes de sécurité

Charge maximale : 50 kg en travers de la table et 75 kg le long de la table selon les normes EN 60601-1 et EN 60601-2.


Avant toute utilisation, assurez-vous de son bon fonctionnement !

Lors du desserrage de la poignée de verrouillage pour régler la hauteur, soutenez l'accessoire pour l'empêcher de descendre de manière incontrôlée en position inférieure.


Le service de maintenance et l'entretien préventif doivent être effectués par du personnel agréé.

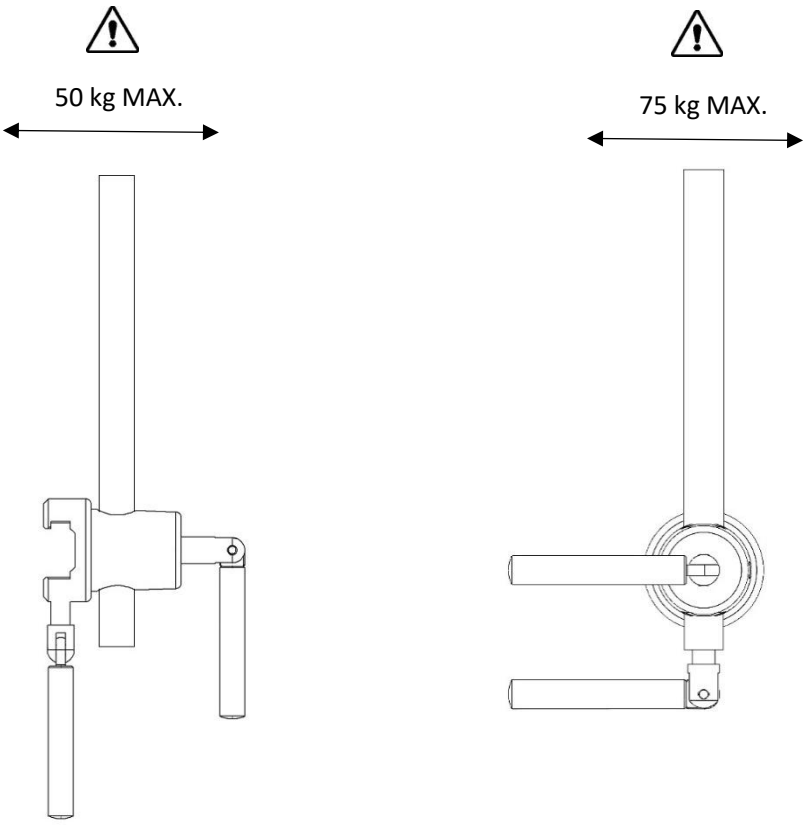

Installation

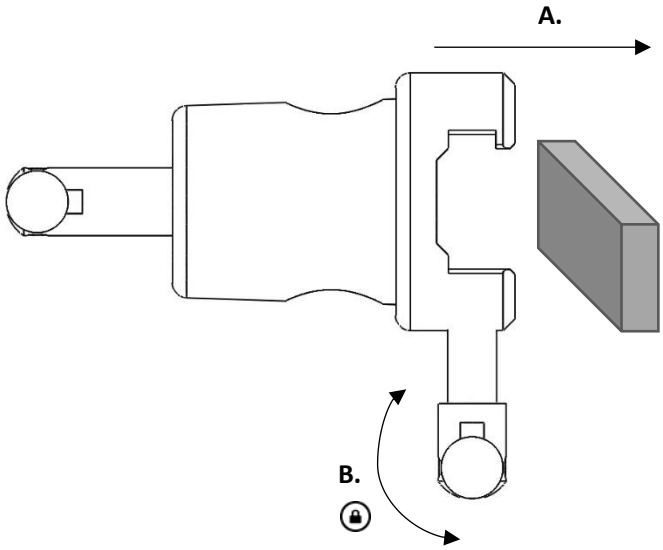

Utilisation

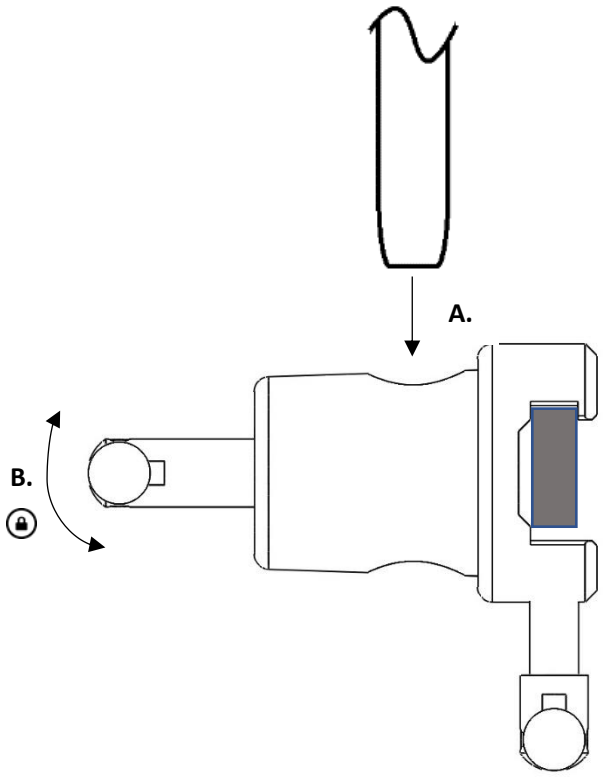

Maintenance



Le service de maintenance, l'entretien préventif, le réglage et les réparations doivent être effectués par du personnel agréé. Modifier la structure sans le consentement écrit du fabricant est strictement interdit.

Nettoyage

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l'eau chaude. Vous pouvez utiliser de l'éthanol. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.


Contrôle

Vérifiez qu'aucune partie n'est desserrée et ni endommagée. Vérifiez la fonction de verrouillage du clameau et la fonction de positionnement et de verrouillage de la tige de l'accessoire dans le clameau.

Entretien annuel

Une fois par an vous devez nettoyer soigneusement le clameau, lubrifier les parties amovibles et tester la fonction de verrouillage.

Pièces de rechange

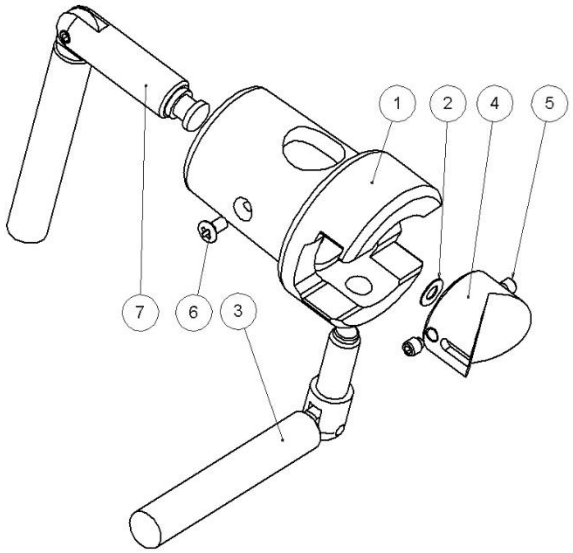

		Version :	10-302	10-302-P
	Description	**Unités**	**Article n°**	**Article n°**
1.	Corps du dispositif de serrage	1	12143	12143
2.	Rondelle PB 5x10x5	1	-	-
3.	Poignée de verrouillage	1	10062	10062
4.	Goujon	1	12145	12146
5.	Vis de réglage MT6SS M5x6 A2	2	-	-
6.	Vis MKFXS M4x8 A2	1	-	-
7.	Poignée de verrouillage	1	10346	10346

Spécifications techniques

Charge de travail maximale	50 kg en travers de la table et 75 kg le long de la table selon les normes EN 60601-1 et EN 60601-2
Poids	0,8 kg
Matériau du clameau	Acier inoxydable
Dimension (h x l x L)	115 x 55 x 55 mm
UDI-DI	10-302 : 07350111830038 10-302-P : 07350111830045

REALME
matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr
1 rue des violettes 80 480 SALEUX

Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SUÈDE
+46 (0)220 433 99 I order@reison.se I info@reison.se

www.realme.fr